



## 職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心

O.S.H.CO., Ltd

測試報告

Test Report

正本  
ORIGINAL

報告日期： 2023/12/29

收件日期： 2023/12/15

測試日期： 2023/12/26

報告編號： BFE-1121215003

測試件類別： 口罩

委託單位： 聚泰環保材料科技股份有限公司

測試地點： 職安衛股份有限公司

連絡地址： 彰化縣二水鄉南通路一段 20 巷 50 號

報告頁數: P 1 / 2

試驗方法、條件說明	試驗項目	試驗結果
1. 測試條件：CNS 14775：2022 2. 本報告樣本數量為 5。 3. 測試樣本/型式：聚泰一般醫療口罩 4. 測試面：外側 5. 測試面積：49 cm <sup>2</sup> 6. 採樣流量：28.3 Liter/min 7. 陽性對照組的平均菌落數：1834 CFU 8. 陰性對照組的平均菌落數：0 CFU 9. 平均粒徑大小：3.1 μm	細菌過 濾效率 (%)	01 >99.9
		02 >99.9
		03 >99.9
		04 >99.9
		05 99.9

6 階 樣品 編號	Anderson 各階菌落數						總菌落數 (CFU)
	第 1 階 (7 μm)	第 2 階 (4.7 μm)	第 3 階 (3.3 μm)	第 4 階 (2.1 μm)	第 5 階 (1.1 μm)	第 6 階 (0.65 μm)	
01	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	1	1
05	0	0	0	0	2	0	2

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心  
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓  
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South  
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817  
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

林鴻維

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人： \_\_\_\_\_  
註記：

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。



職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心

O.S.H.CO., Ltd

測試報告

Test Report

正本  
ORIGINAL

報告日期： 2023/12/29

收件日期： 2023/12/15

測試日期： 2023/12/26

報告編號： BFE-1121215003

測試件類別： 口罩


委託單位： 聚泰環保材料科技股份有限公司

測試地點： 職安衛股份有限公司

連絡地址： 彰化縣二水鄉南通路一段 20 巷 50 號

報告頁數: P 2/2

測試樣本式樣：

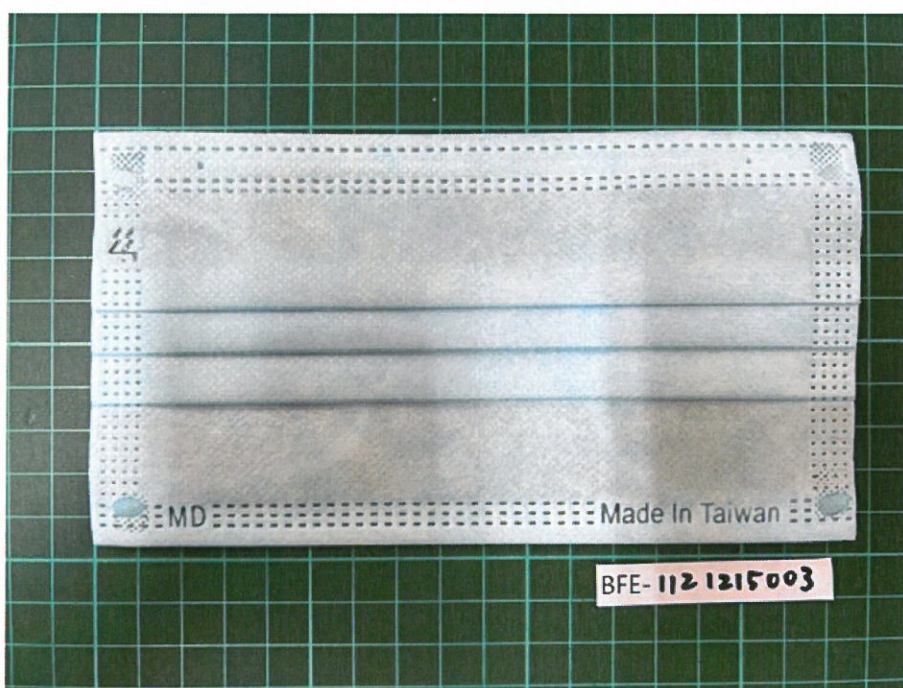

BFE-1121215003

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品符合性做判斷。
2. 依循標準 CNS 14774 (2022)第 9.2 節引用之 CNS 14775。

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心  
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓  
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South  
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817  
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人：\_\_\_\_\_

註記：

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。

林鴻維





職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心  
O.S.H.CO., Ltd  
測試報告  
Test Report

正本  
ORIGINAL

報告日期： 2023/12/29 收件日期： 2023/12/15 測試日期： 2023/12/25  
報告編號： AEP-1121215003 測試件類別： 口罩  
委託單位： 聚泰環保材料科技股份有限公司 測試地點： 職安衛股份有限公司  
連絡地址： 彰化縣二水鄉南通路一段 20 巷 50 號

報告頁數: P 1/2

測試方法	測試項目	測試結果
測試方法、條件說明 1. 測試條件：CNS 14777：2003 2. 本報告樣本數量為 5。 3. 流率：8.05 Liter/min 4. 測試樣本/型式： 聚泰一般醫療口罩	醫用面罩空氣交換壓力 (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	01 2.36
		02 2.50
		03 2.47
		04 2.45
		05 2.39
		平均 2.43

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品符合性做判斷。
2. 依循標準 CNS 14774 (2022) 第 9.4 節引用之 CNS 14777。

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心  
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓  
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South  
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817  
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人：  
註記：

郭安茹

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。



職安衛股份有限公司呼吸防護具檢測中心

O.S.H.CO., Ltd

測試報告

Test Report

正本  
ORIGINAL

報告日期： 2023/12/29

收件日期： 2023/12/15

測試日期： 2023/12/25

報告編號： AEP-1121215003

測試件類別： 口罩


委託單位： 聚泰環保材料科技股份有限公司

測試地點： 職安衛股份有限公司

連絡地址： 彰化縣二水鄉南通路一段 20 巷 50 號

報告頁數: P 2/2

測試樣本式樣：

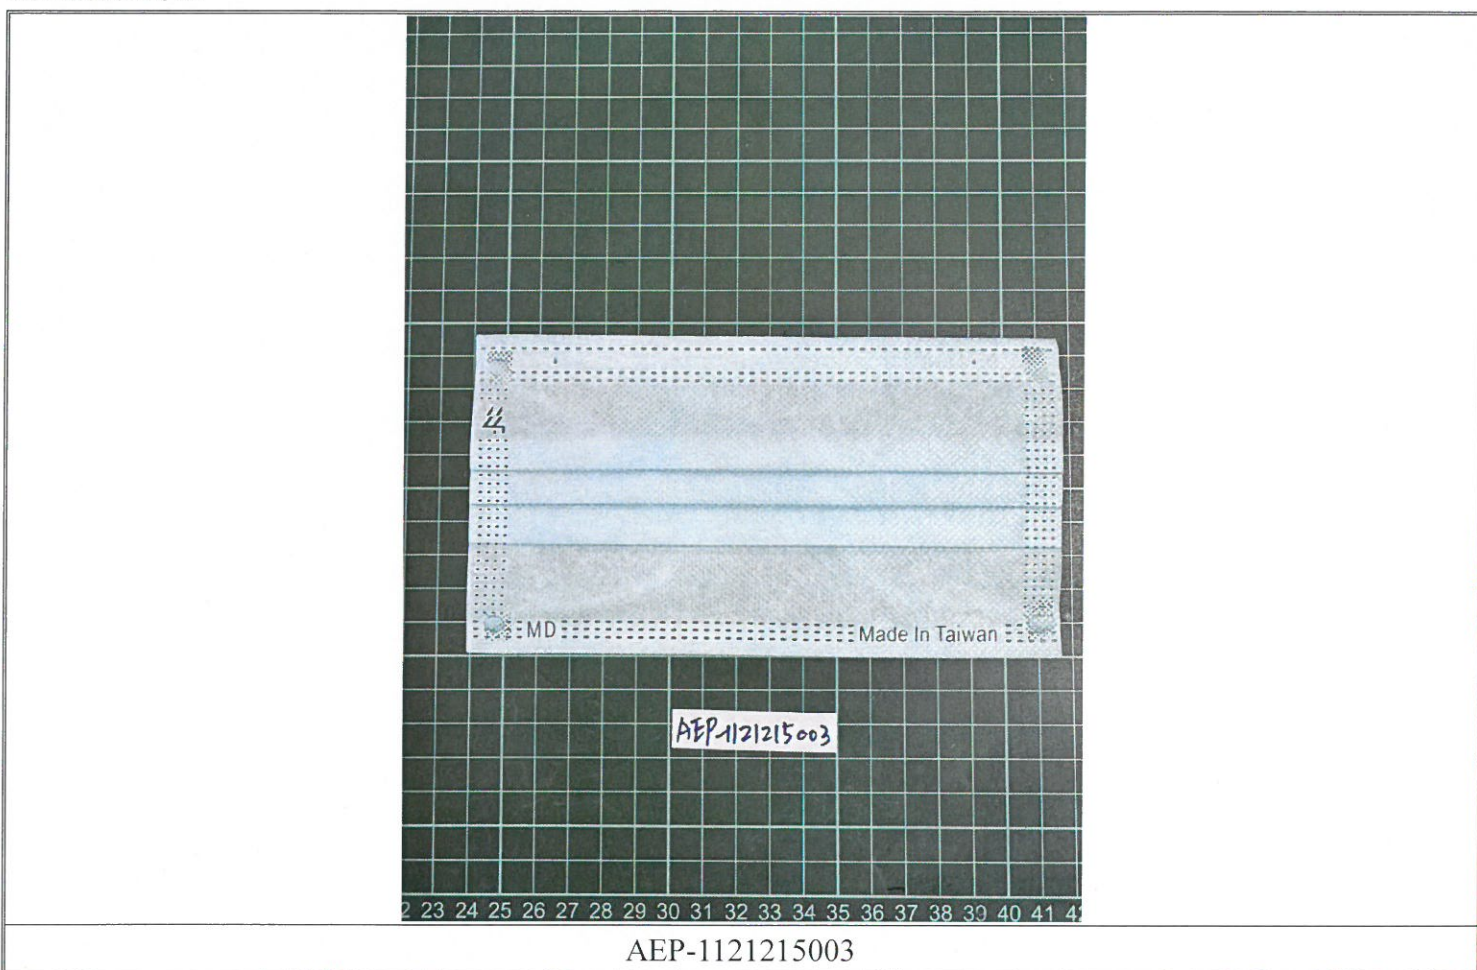

職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心  
402 台中市南區復興北路 102 號 1 樓  
1st F., No.102, Fuxing N. Rd., South  
Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: 04-22601786 Fax: 04-22602817  
E-mail: osh.scba@msa.hinet.net

職安衛股份有限公司

呼吸防護具檢測中心 報告簽署人：

註記：

1. 本報告僅對測試樣本負責，測試樣本保留期限一個月。
2. 本報告非經本檢測部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3. 本報告所載事項，僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。

郭安茹